MedTex
Medical textile

NYOrtho ZERO-G Boot™

דגם 9518

NYOrtho ZERO-G Boot™ מסייע לבטל את הלחץ והחיכוך על העור, ומשאיר את העקב מרחף מעל חלל אוויר המספק זרימת אוויר לסיוע בריפוי כיבים קיימים.

שימוש מומלץ: אנשים שאינם יכולים להימנע מפרקי זמן ארוכים של לחץ רצוף על בליטות גרמיות נמצאים בסיכון מוגבר להתפתחות נמק וכיבים.

קטיפה רכה במיוחד

מגינה על עור דק ושברירי מפני קרעים הנגרמים מטראומה, ומפחיתה חיכוך וגזירה.

אנטי-מיקרוביאלי

ללא ריח, ללא חיידקים: הודות לפונקציית ההיגיינה המובנית.

רצועה מתכווננת

מאפשרת לקבע את המוצר בשני מיקומים חלופיים. המיקום התחתון שולט בכפיפה הגבית של כף הרגל.

ניתן לכביסה במכונה

ראו את תווית הטיפול להוראות כביסה.



NYOrtho ZERO-G Boot™

מוצג בחתך המראה את העקב מרחף מעל חלל האוויר, שכבות הקצף וכרית הג'ל.

סגירת סקוצ' מרופדת
סגירה מרופדת קלה להלבשה ולהסרה, המאפשרת הנחה והסרה קלות בהתאמה נוחה.

צדדים מרופדים בקצף
הקרסוליות החיצונית והפנימית – הבליטות הגרמיות משני צדי הקרסול – מרופדות ברכות.

אפס לחץ
עיצוב מרופד מוארך משאיר את העקב מרחף מעל חלל אוויר לאפס לחץ, ומספק זרימת אוויר לסיוע בריפוי כיבים קיימים.

כרית ג'ל נשלפת
ניתן להשתמש בה להפחתה נוספת של הלחץ מתחת לקרסול, והיא שומרת על כפות הרגליים קרירות. (FA-GEL-4X8)

800.699.2358 www.nyorthousa.com



אפס לחץ
חלל אוויר פתוח לאפס לחץ מתחת לעקב.

MedTex Medical textile

NYOrtho ZERO-G Boot™
הוראות שימוש
דגם 9518

B. יש להזיז את הרצועה התחתונה למיקום הנוח ביותר עבורכם. אם בחרתם במיקום התחתון שבאיור B1, המשיכו לאיור C1.

אם בחרתם במיקום הגבוה שבאיור B2, המשיכו לאיור C2.

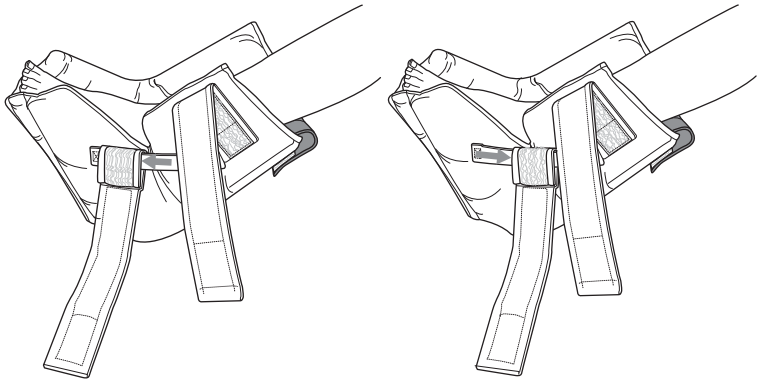

איור B1 איור B2

A. כדי להוציא או להחזיר את כרית הג'ל, יש לקלף לאחור את כיסוי הבד ולהכניס את כרית הג'ל. ראו איור A1.

יש להניח את כף רגלו של המטופל בתוך ה-Zero-G Boot כשהעקב תלוי מעל פתח חלל האוויר. ראו איור A2.

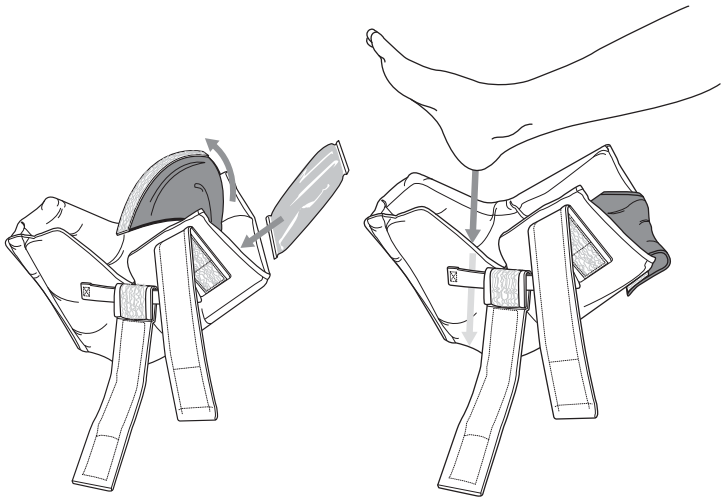

איור A1 איור A2

D. בהתאם למיקום הרצועה שבחרתם, יש לסגור את סגירת הסקוצ' כך שתהיה צמודה אך לא הדוקה.

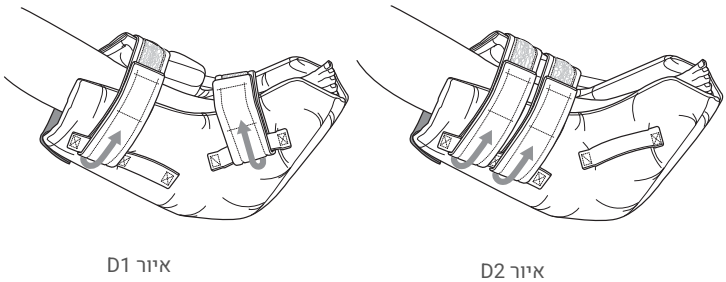

איור D1 איור D2

C. בהתאם למיקום הרצועה שבחרתם, יש להעביר את רצועת הסקוצ' לתוך הלולאות שבצד הנגדי.

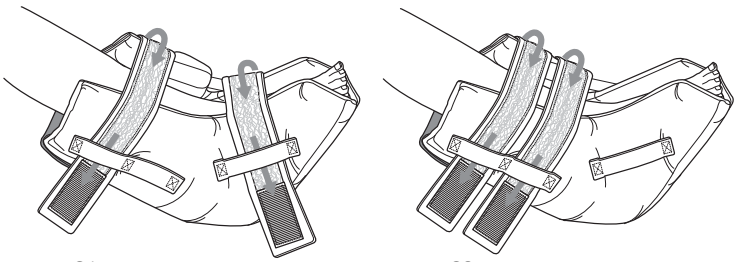

איור C1 איור C2

איך למדוד

לבחירת המידה הנכונה, יש למדוד את היקף החלק התחתון של שריר השוק.

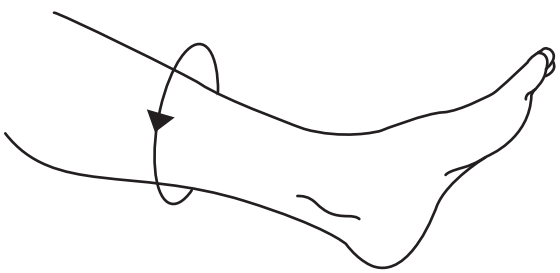

דגם	מידה	היקף	מתאים ל-
9518-S	קטן	5-10 אינץ'	מבנה קטן
9518-M	בינוני	11-20 אינץ'	מבוגר
9518-L	גדול	21-25 אינץ'	בריאטרי

בדיקות מעבדה בלתי תלויות באמצעות מוניטור לחץ ממשק C-PicoPress, בטמפרטורת סביבה התואמת לתקן ISO 554-1976E, מוכיחות כי הלחץ מוסר ביעילות מהעקב.

EC Service Project#1385

© 2023

800.699.2358 www.nyorthousa.com